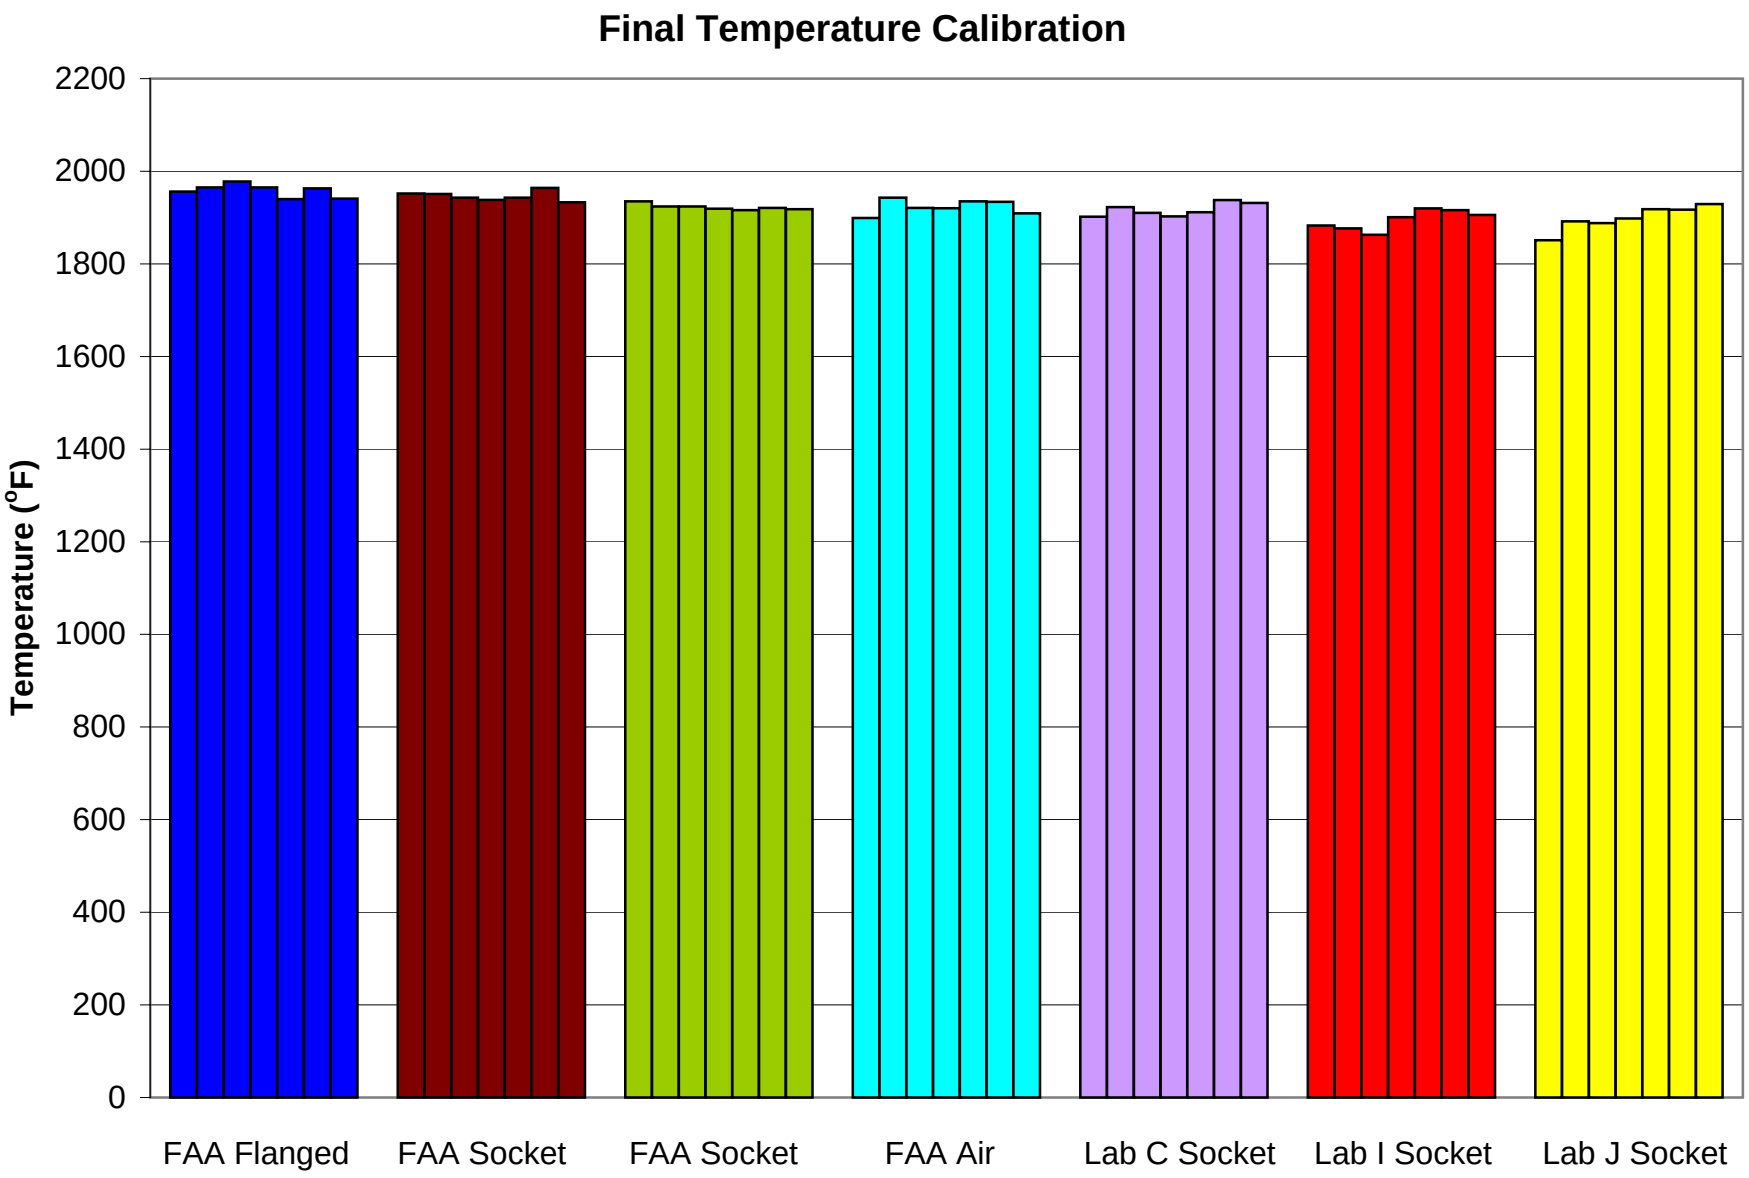
Final Temperature Calibration
Temperature (°F)
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
FAA Flanged
FAA Socket
FAA Socket
FAA Air
Lab C Socket
Lab I Socket
Lab J Socket